



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

contato, uma vez que o número de telefone disponibilizado não atende ou não está mais funcionando. Tendo em vista a importância da análise, consultamos pacientes que já usam as bolsas a certo tempo.

**ANALISE DOS DISPOSITIVOS DA MARCA MASTER WIN – BOLSA DE COLOSTOMIA  
1 PEÇA COM ADESIVO MICROPOROSO ITENS 15, 18 e 22 DA LICITAÇÃO**

Se faz necessário enfatizar que as bolsas foram testadas em 11 (Onze) pacientes cadastrados no setor e que utilizam diariamente bolsas de ostomias.

Foram relatados por dois (02) pacientes que a bolsa causou irritação na pele, formando um ferida ao ser retirada, o que gerou complicações causando dor e incomodo; Dois (02) pacientes disseram que a bolsa teve uma baixa fixação durando apenas 1 dia ; Cinco (05) pacientes não sentiram-se seguros com o clamp de fechamento da bolsa; segundo cinco (05) pacientes o filtro de carvão ativado libera odor para o ambiente, o que os impossibilitou de sair para realizar suas atividades já que se sentiram constrangidos; dois (2) pacientes relataram dificuldade quanto a limpeza da bola e cinco (05) relataram dificuldade na retirada da mesma, o que ocasionou dor.

**Diante de todos os fatores acima citados, fica evidente que as bolsas avaliadas e testadas não atenderam as necessidades dos pacientes ostomizados do setor de órtese e prótese do PAM-Salgadinho. Sendo assim uma condição eliminatória.**

**Conclusão das amostras testadas:**

É preciso lembrar que os pacientes portadores de ostomias, utilizam a bolsa de colostomia para a eliminação dos efluentes fisiológicos do corpo humano, já que devido a patologia perdem o controle natural. Esta bolsa deve ser forte o suficiente para ficar aderida junto a pele do paciente, permitindo que ele possa se deslocar de um lugar para o outro sem que haja o desprendimento desta bolsa e conseqüentemente de suas fezes ou urina em via pública. Por isto, a bolsa deve proporcionar segurança suficiente e não permitir vazamentos, passagem de odor ou irritação na pele dos pacientes, provocando situações, no mínimo vexatórias.

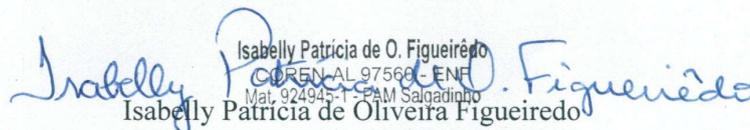


ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE


O entendimento de que a administração não tem o condão de eleger critérios específicos nos itens de referência, porque desse modo prejudica a isonomia entre os fornecedores e pode perder a oferta mais vantajosa, favorece a ineficiência do serviço público, como consequência de obtenção de produtos sem conhecimento efetivo da qualidade, sendo necessário testar os materiais ganhos na licitação, para que seja adequado as necessidades do usuário.

Cumpre-se aqui, mais uma vez frisar, que o objetivo dessa licitação, é a compra de produtos que entram em contato diretamente com a pele dos pacientes, sendo por isso específico desde a sua origem, pois a finalidade desta compra é atender ao maior número de pessoas possíveis que daqui dependem, com todas as suas nuances, valendo também salientar que esta casa já se viu diante de situações onde os pacientes apresentaram dermatites, irritabilidades da pele, e descolamento prévio da bolsa, quando utilizaram produtos sem observância de suas especificações, trazendo prejuízo ao erário público com o tratamento dos pacientes afetados, e principalmente trazendo prejuízos a saúde e integridade física e moral desta população que já é tão prejudicada.

Sendo assim, diante de todos os fatores expostos e citados neste relatório sobre as amostras, as bolsas avaliadas e testadas pelos pacientes do setor, não atendem as necessidades dos mesmos por possuírem vários pontos negativos relacionados ao uso destas, que causam desconforto e prejuízo a saúde de quem delas faz uso.

  
Isabelly Patricia de O. Figueiredo  
COREN AL 97566 - ENF  
Mat. 924945-1 - PAM Salgado

**Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese**

  
Natália Holanda de Carvalho  
mat. 645

**Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho

Maceió, 21 de Setembro de 2022

**RELATÓRIO FINAL DOS TESTES COM OS DISPOSITIVOS DO EDITAL DE PREGÃO  
ELETRÔNICO – CPL/ARSER Nº 144 /2022**

CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública, conforme previsto no art.197, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, que aprova a estrutura organizacional e o detalhamento completo dos procedimentos da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, entre eles os equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas ostomizadas;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza interdisciplinar e que o pleno atendimento às suas necessidades depende da qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (Portaria 400 de 16/09/2009);

Vimos por meio deste, relatar a experiência dos pacientes deste Unidade Especializada de Saúde – PAM Salgadinho, setor de Órtese e Prótese, na utilização de bolsas fechadas de ostomias da marca CONVATEC. Estas, fornecidas a Secretaria Municipal de Saúde para testes após ganharem o processo de licitação do ano corrente, devido o desconhecimento do material, nesse caso a bolsa fechada de ostomia.

Se faz necessário enfatizar que as bolsas foram testadas em 3 (três) pacientes, devido a quantidade de amostra disponibilizadas para testes, além da dificuldade de usuários dispostos a colaborar nos testes. Alguns por morarem distante, interior, outros por não conseguirmos contato,



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

uma vez que o número de telefone disponibilizado não atende ou não está mais funcionando. Tendo em vista a importância da análise, consultamos pacientes que já usam as bolsas a certo tempo.

**ANALISE DOS DISPOSITIVOS DA MARCA CONVATEC – BOLSA DE COLOSTOMIA  
FECHADA SEM ADESIVO MICROPOROSO ITEM 01 DA LICITAÇÃO**

A bolsa fechada da marca Convatec se mostrou com pouca adesividade para a maioria dos pacientes que a testaram. Dos 3 (três) pacientes que se disponibilizaram a realizar o teste, 2 (dois) pacientes relataram que a bolsa tem pouca adesividade, ficando em média menos de 1 dia sendo necessário a troca devido à falta de funcionalidade do filtro. Segundo os mesmos, a bolsa ficou cheia de ar o que os impossibilitavam de realizar suas atividades diárias, e como não é drenável, houve a necessidade de retirada da mesma. Um dos pacientes relatou muita passagem do odor pelo filtro de carvão. Segundo 2 (dois) pacientes o adesivo da bolsa ficou aderido na pele após a retirada da mesma, não saindo por completo, o que fez com que o mesmo fosse retirado com muita dificuldade e aos pedaços.

**Diante de todos os fatores acima citados, fica evidente que as bolsas avaliadas e testadas não atendem as necessidades dos pacientes ostomizados do setor de órtese e prótese do PAM-Salgadinho.**

**Conclusão das amostras testadas:**

É preciso lembrar que os pacientes portadores de ostomias, utilizam a bolsa de colostomia para a eliminação dos efluentes fisiológicos do corpo humano, já que devido a patologia perdem o controle natural. Esta bolsa deve ser forte o suficiente para ficar aderida junto a pele do paciente, permitindo que ele possa se deslocar de um lugar para o outro sem que haja o desprendimento desta bolsa e conseqüentemente de suas fezes ou urina em via pública. Por ser uma bolsa fechada, o que não possibilita a saída de gases, a bolsa deve ter um filtro que funcione para eliminação dos gases e não permitir a passagem de odor destes gases para o ambiente provocando situações, no mínimo vexatórias.



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE**

O entendimento de que a administração não tem o condão de eleger critérios específicos nos itens de referência, porque desse modo prejudica a isonomia entre os fornecedores e pode perder a oferta mais vantajosa, favorece a ineficiência do serviço público, como consequência de obtenção de produtos sem conhecimento efetivo da qualidade, sendo forçoso a adquirir material desconhecido, não atendendo ao objetivo principal, qual seja, as necessidades do usuário.

Cumpre-se aqui, mais uma vez frisar, que o objetivo dessa licitação, é a compra de produtos que entram em contato diretamente com a pele dos pacientes, sendo por isso específico desde a sua origem, pois a finalidade desta compra é atender ao maior número de pessoas possíveis que daqui dependem, com todas as suas nuances, valendo também salientar que esta casa já se viu diante de situações onde os pacientes apresentaram dermatites, irritabilidades da pele, e descolamento prévio da bolsa, quando utilizaram produtos sem observância de suas especificações, trazendo prejuízo ao erário público com o tratamento dos pacientes afetados, e principalmente trazendo prejuízos a saúde e integridade física e moral desta população que já é tão prejudicada.

Sendo assim, diante de todos os fatores expostos e citados neste relatório sobre as amostras, as bolsas avaliadas e testadas pelos pacientes do setor, não atendem as necessidades dos mesmos por possuírem vários pontos negativos relacionados ao uso destas, que causam desconforto e prejuízo a saúde de quem delas faz uso.

*Isabelly P. O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese**

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho

**Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 21 de Setembro de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

**- EMPRESA: TECNOVIDA HOSPITALAR**

**- MARCA: Coloplast**

→ O item 17 possui o descritivo citado de acordo com o descritivo exarado no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 12 anos (Coloplast), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**

Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho

Maceió, 09 de novembro de 2022

**RELATÓRIO FINAL DOS TESTES COM OS DISPOSITIVOS DO EDITAL DE PREGÃO  
ELETRÔNICO – CPL/ARSER Nº 144/2022**

CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública, conforme previsto no art.197, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, que aprova a estrutura organizacional e o detalhamento completo dos procedimentos da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, entre eles os equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança para pessoas ostomizadas;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir às pessoas ostomizadas a atenção integral à saúde por meio de intervenções especializadas de natureza interdisciplinar e que o pleno atendimento às suas necessidades depende da qualificação dos processos de atenção que incluem prescrição, fornecimento e adequação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (Portaria 400 de 16/09/2009);

Vimos por meio deste, relatar a experiência dos pacientes desta Unidade Especializada de Saúde – PAM Salgadinho, setor de Órtese e Prótese, na utilização de bolsas de ostomias da marca HOLLISTER. Estas, fornecidas a Secretaria Municipal de Saúde para testes após ganharem o processo de licitação do ano corrente. Solicitamos o período de teste, ainda que tenham ganho a licitação, devido o desconhecimento do material, nesse caso a bolsa de ostomias.

Se faz necessário enfatizar que as bolsas foram testadas em 05 (cinco) pacientes. Fora realizados testes em apenas 05 (cinco) pacientes devido a quantidade de amostras disponibilizadas e a dificuldade de usuários dispostos a colaborar na pesquisa. Alguns por morarem distante, interior, outros por serem muito carentes e não terem condições de pagar o transporte. Tendo em vista a



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

importância da análise, consultamos pacientes que já usam as bolsas a certo tempo.

**ANALISE DOS DISPOSITIVOS DA MARCA HOLLISTER – BOLSA DE COLOSTOMIA 1  
PEÇA COM ADESIVO MICROPOROSO ITEM 18 DA LICITAÇÃO**

A bolsa de 1 peça da marca Hollister se mostrou com pouca adesividade para a maioria dos pacientes que a testeram. Dos 5 (cinco) pacientes que se disponibilizaram a realizar o teste, 1 não retornou para concluir o teste, os outros relataram que a bolsa tem uma baixa adesividade, 02 (dois) relataram que a bolsa ficou menos de 1 dia e 02 ficando em média 3 dias sendo necessário a retirada da bolsa por apresentar um intenso prurido na pele, descolamento ou passagem de odor o que os impossibilitavam de realizar suas atividades diárias. Dos pacientes testados o relato em relação ao clamp foi que se sentiram inseguros. Foram relatados danos relacionados a pele peristoma tais como: prurido intenso, irritação e vermelhidão que provocaram dermatite.

**Os relatos negativos sobre esta bolsa foram em relação a pele que causou dermatite e a durabilidade de uso, “só chegava a menos de 01 dia de uso”, fugindo a realidade das outras bolsas utilizadas no setor as quais duram em torno de 05 a 07 dias;**

**Diante de todos os fatores acima citados, fica evidente que as bolsas avaliadas e testadas não atendem as necessidades dos pacientes ostomizados do setor de órtese e prótese do PAM-Salgadinho.**

**Conclusão das amostras testadas:**

É preciso lembrar que os pacientes portadores de estomias, utilizam a bolsa de colostomia para a eliminação dos efluentes fisiológicos do corpo humano, já que devido a patologia perdem o controle natural. Esta bolsa deve ser forte o suficiente para ficar aderida junto a pele do paciente, permitindo que ele possa se deslocar de um lugar para o outro sem que haja o desprendimento desta bolsa e conseqüentemente de suas fezes ou urina em via pública. Por isto, a bolsa deve ter placa adesiva forte o suficiente para ficar presa à pele do paciente e não permitir vazamentos destes efluentes para a pele provocando irritações cutâneas, nem em qualquer outro lugar, provocando situações, no mínimo vexatórias.



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE

O entendimento de que a administração não tem o condão de eleger critérios específicos nos itens de referência, porque desse modo prejudica a isonomia entre os fornecedores e pode perder a oferta mais vantajosa, favorece a ineficiência do serviço público, como consequência de obtenção de produtos sem conhecimento efetivo da qualidade, sendo forçoso a adquirir material inferior, não atendendo ao objetivo principal, qual seja, as necessidades do usuário.

Cumpre-se aqui, mais uma vez frisar, que o objetivo dessa licitação, é a compra de produtos que entram em contato diretamente com a pele dos pacientes, sendo por isso específico desde a sua origem, pois a finalidade desta compra é atender ao maior número de pessoas possíveis que daqui dependem, com todas as suas nuances, valendo também salientar que esta casa já se viu diante de situações onde os pacientes apresentaram dermatites, irritabilidades da pele, e descolamento prévio da bolsa, quando utilizaram produtos sem observância de suas especificações, trazendo prejuízo ao erário público com o tratamento dos pacientes afetados, e principalmente trazendo prejuízos a saúde e integridade física e moral desta população que já é tão prejudicada.

Sendo assim, diante de todos os fatores expostos e citados neste relatório sobre as amostras, as bolsas avaliadas e testadas pelos pacientes do setor, não atendem as necessidades dos mesmos por possuírem vários pontos negativos relacionados ao uso destas, que causam desconforto e prejuízo a saúde de quem delas faz uso.

*Isabelly Patrícia de O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta do Setor de Órtese e Prótese**

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho *mat 645*

**Coordenadora do Setor de Órtese e Prótese**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 21 de setembro de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

**- EMPRESA: HOLLISTER DO BRASIL**

**- MARCA: HOLLISTER**

→ O item 19 possui o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, sendo assim não houve necessidade de ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 05 anos (Hollister), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso desta bolsa.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Isabelly P. O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 11 de Outubro de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

**- EMPRESA: IMBRASUL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

**- MARCA: Master Win**

→ O item 01 foi solicitada bolsa fechada e **NÃO** drenável, porém na amostra a empresa enviou bolsa de 1 peça drenável o que não será aceitável uma vez que esse item se refere a bolsas fechadas que são usadas por pacientes que fazem irrigação intestinal.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação da amostra e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Isabelly Patrícia de O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
COBEN-AL 97560-ENF  
Mat. 024045-01 PAM Salgadinho

**Enfermeira Estomaterapeuta**

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho

**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 19 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:


- **EMPRESA: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA**


- **MARCA: Coloplast**

→ O item 16 possui o descritivo citado de acordo com o descritivo exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 12 anos (Coloplast), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 24945-1 - PAM Salgadinho  
**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 19 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:


**- EMPRESA: B/BRAUN SHARING EXPERTISE**


**- MARCA: B/Braun**

→ O item 17 foi ganho pela marca B/BRAUN e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessária amostras para teste com o mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 ás 16h de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
ENF - AL 97560 - ENF  
Mat. 924945-1 - PAM Salgadinho  
**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 05 de Novembro de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

**- EMPRESA: HOLLISTER DO BRASIL**

**- MARCA: HOLLISTER**


→ O item 18 foi ganho pela marca HOLLISTER e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessária amostras para teste com o mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizaél Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 ás 16h de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: B/BRAUN SHARING EXPERTISE**
- **MARCA: B/Braun**

→ O item 19 possui descritivo de bolsa de duas (2) peças de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, no entanto, a empresa acima citada cotou para este item bolsa de 1 peça, o que não está de acordo com o solicitado e portando será descredenciada.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Isabelly Patrícia de O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
CREN-AL 97560 - ENF  
Enfermeira Estomatoterapeuta

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho  
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 16 de Agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de colostomia/urostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

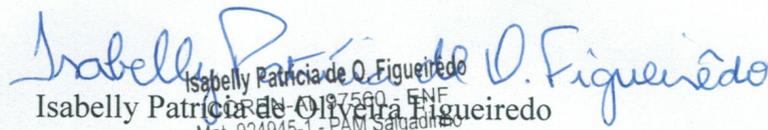
- **EMPRESA: HOLLISTER DO BRASIL**
- **MARCA: HOLLISTER**

→ O item 19 será solicitado amostra para ser testado e avaliado pelos pacientes e técnicos do setor para emissão de parecer final. Apesar de a marca já ser conhecida em nosso setor necessitamos de uma avaliação do produto de acordo com o descritivo solicitado.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação do descritivos e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

As amostras deverão ser entregues no posto de atendimento médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, s/n Poço – Maceió-AL. No período de 7 ás 16h de segunda a sexta-feira.

Atenciosamente,

  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 924945-1 - PAM Salgadinho  
**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: F & L HOSPITALAR**
- **MARCA: HOLLISTER**

→ O item 23 possui descritivo de bolsa de duas (2) peças de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, no entanto, a empresa acima citada cotou para este item bolsa de 1 peça, o que não está de acordo com o solicitado e portando será descredenciada.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

Enfermeira Estomaterapeuta  
COREN-AL 97560 - ENF  
Mat. 924945-1 - PAM Salgadinho

*Natália Holanda de Carvalho*

Natália Holanda de Carvalho  
Coordenação do Setor de Órteses e Próteses



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE**

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: ARSERVE PHARMA EPP LTDA**
- **MARCA: ESTEEM PLUS CONVATEC/ SURFIT ADVANTAGE**

→ Os itens 01 e 08 foram ganhos pela marca Convatec e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessária amostras para teste com o mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.

  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 924945-1 - PAM Salgadinho  
**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: ARSERVE PHARMA EPP LTDA**
- **MARCA: ESTEEM PLUS CONVATEC/ SURFIT ADVANTAGE**

→ Os itens 01 e 08 foram ganhos pela marca Convatec e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessária amostras para teste com o mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.

  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 924945-1 - PAM Salgadinho  
**Enfermeira Estomaterapeuta**

  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgado, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: NUTRI HOSPITALAR**

- **MARCA: Coloplast**

→ Os itens 05 e 07 possuem o descritivo citado de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 12 anos (Coloplast), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 524943-1 - PAM Salgado

**Enfermeira Estomaterapeuta**



Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 05 de Novembro de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: ARSERVE PHARMA EPP LTDA**
- **MARCA: ACTIVE LIFE**

→ Os itens 15 e 22 foram ganhos pela marca Active Life Convatec possuem o descritivo citado de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 17 anos (Covatec), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

*Isabelly P. O. Figueiredo*  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**

*Natália Holanda de Carvalho*  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**


Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: IMBRASUL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**
- **MARCA: MASTER WIN**

→ Os itens 15, 18 e 22 foram ganhos pela marca Master Win e se referem a um equipamento não utilizado no setor por nenhum paciente, sendo necessárias amostras para teste com os mesmo e posterior emissão de relatório com análise do produto e do teste realizado.

As amostras deverão ser entregues no Posto de Atendimento Médico PAM Salgadinho, localizado á rua Mizael Domingues, S/N – Poço – Maceió – AL. no período de 7 às 16h de segunda a sexta-feira.

  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo  
COBEN-AL 97560-ENF  
Isabelly Patrícia de O. Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**



Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 12 de Agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – Nº 144/2022-CPL/ARSER:

**- EMPRESA: IMBRASUL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

**- MARCA: Master Win**

→ Os itens 16,17,20 e 21 foram solicitados que as bolsas fossem recortáveis no diâmetro de 10 á 76mm e que **NÃO** tivessem adesivo microporoso, porém no descritivo da empresa foi apresentado bolsa no diâmetro de **25 á 70mm e contendo adesivo microporoso**, o que não será aceitável uma vez que alguns pacientes necessitam de bolsa com o recorte maior que 70mm e que em outros itens do descritivo já contém bolsas com o **adesivo microporoso**.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
COREN/AL 97560 ENF  
Mat. 24945-1 - PAM Salgadinho

**Enfermeira Estomaterapeuta**

Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SETOR DE ORTESE E PRÓTESE

Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgado, Maceió, 19 de agosto de 2022.

**ANÁLISE DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

Segue abaixo o resultado da análise dos descritivos das bolsas de Colostomia/Ileostomia solicitadas mediante PE – N° 144/2022-CPL/ARSER:

- **EMPRESA: NUTRI HOSPITALAR**
- **MARCA: Coloplast**

→ Os itens 20 e 21 possuem o descritivo citado de acordo com os descritivos exarados no Termo de Referência, sendo assim não precisa ser testado, bem como, a marca acima citada já é fornecedora há aproximadamente 12 anos (Coloplast), tempo suficiente e necessário para afirmar com precisão que os pacientes já estão devidamente acostumados e adaptados ao uso destas bolsas.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo  
Mat. 924945-1 - PAM Salgado  
COREN-AL 97560 ENF  
Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo

**Enfermeira Estomaterapeuta**

Natália Holanda de Carvalho.  
Natália Holanda de Carvalho  
**Coordenação do Setor de Órteses e Próteses**